



TLV • Abteilung Gesundheitlicher und technischer Verbraucherschutz
Postfach 10 01 41 • 98490 Suhl

Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Lange Straße 71
D-07551 Gera

Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Herr Barthelmes

Durchwahl
Telefon +49 361 57-3815000
Telefax +49 361 57-3815010

marktueberwachung@
tlv.thueringen.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
D21S1/027710620

Abteilung Gesundheitlicher und
technischer Verbraucherschutz
Dezernat 21
Karl-Liebknecht-Straße 4
98527 Suhl

11. September 2020

BESTÄTIGUNG

gemäß § 9 Absatz 3 der

Verordnung zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Produkten

des

medizinischen Bedarfs bei der durch das Coronavirus SARS-CoV-2

verursachten Epidemie

(Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung – MedBVSV)

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt

Bezeichnung	Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutz- maske (CPA)
Modell	Falt-Pandemic Art.-Nr.: 20200804
Hersteller	Thorey Gera Textilveredelung GmbH Lange Straße 71 D-07551 Gera
Importeur	-
ggf. Chargennum- mer	-

Thüringer Landesamt
für Verbraucherschutz
Tennstedter Straße 8/9
99947 Bad Langensalza

www.verbraucherschutz-thueringen.de

Bankverbindung:
Landesbank Hessen-Thüringen
IBAN: DE15820500003004444026
BIC: HELADEF820

nach Maßgabe des § 9 Absatz 2 MedBVS zur Versorgung der Bevölkerung mit Produkten des medizinischen Bedarfs für den begrenzten Zeitraum der derzeitigen epidemischen Lage von nationaler Tragweite bereitgestellt werden kann, ohne die Voraussetzungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung vollumfänglich zu erfüllen.

In dem Bewertungsverfahren aufgrund eines von der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) veröffentlichten Prüfgrundsatzes ist durch die Prüfstelle

Prüfstelle	Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e.V.
Prüfungsdatum	08.09.2020
Prüfnummer / Berichtsnummer	525/20
ICSMS PI	200900165512

festgestellt worden, dass das Produkt ein den grundlegenden Anforderungen der VO (EU) 2016/425 vergleichbares Gesundheits- und Sicherheitsniveau bietet (§ 9 Abs.2 MedBVS). Das hier erfolgreich bestandene Bewertungsverfahren entspricht jedoch keinem vollständigen nach der VO (EU) 2016/425 erforderlichen Konformitätsbewertungsverfahren. Aus diesem Grund darf an diesen Produkten **keine Kennzeichnung mit CE, DIN EN 149 oder FFP“X“, IIR** angebracht werden.

Diese Bestätigung ist in Kopie an alle Käufer bzw. Zwischenhändler bis zum Verwender jeder Abgabeeinheit beizufügen.




Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz

Dezernat 21

Technischer Verbraucherschutz, Marktüberwachung

X Suhl, 08.09.2020
Karl-Liebknecht-Straße 4
98521 Suhl

Ausstellende Behörde, Ort, Datum

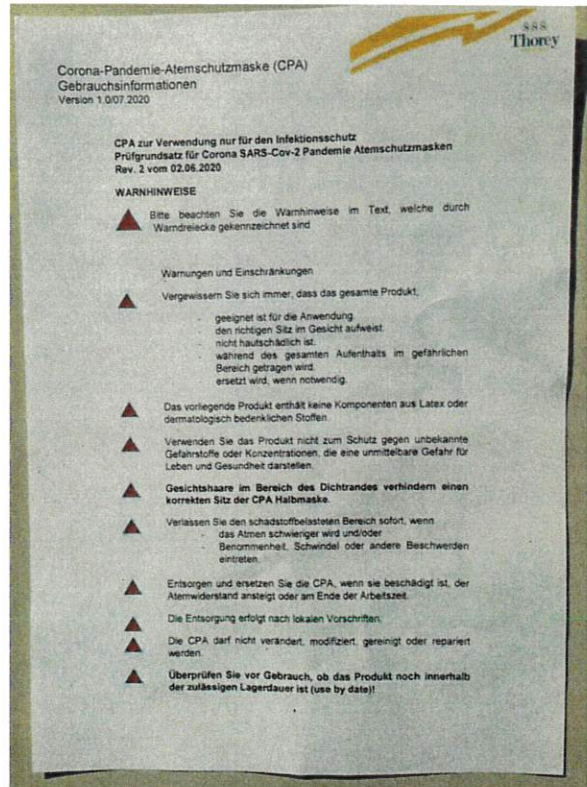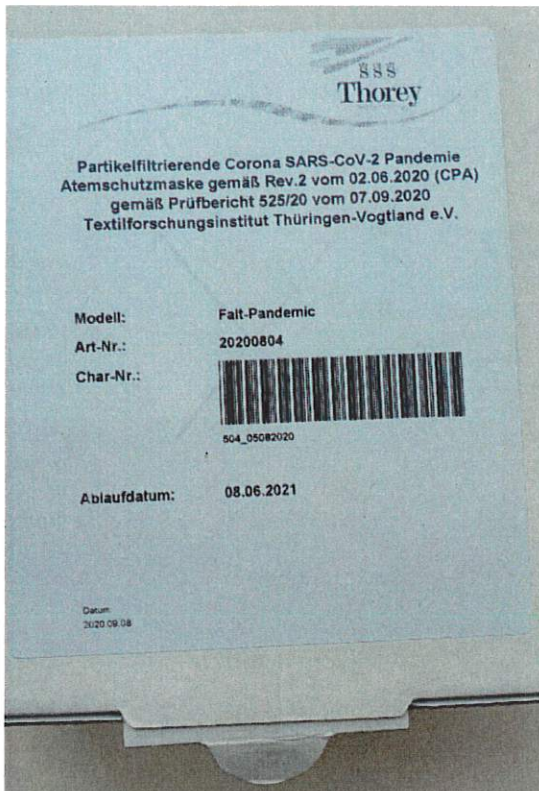

Verteiler:

I. TLV DZ 21

II. Adressat (per E-Mail)